



389.7.  
2011

7

ISO 389-7:2005  
Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 7.  
Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions  
(IDT)



2012

27 2002 . 184- « — 1.0—2004 « », »

1 « - » ( « 4 ») ,

2 358 « »

3 8 1 2011 . Ne 671- -

4 389-7:2005 « . 7. -

Reference for the calibration of audiometric equipment — Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions»}.

1.5 ( 3.5). -

5

« » . « » . — - ( ) « » . « » . -

8

-  
-

8253-1

8253-2.

8

18

25

a)

( ) ,

b)

1/3-

( )

8

( ) ,

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

7

8

State system (or ensuring the uniformity of measurements. Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 7. Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions

— 2012—12—01

1

a)

),

8253-2.

(

b)

).

)

c)

— 1/3-

(

d)

1 8

8253-2

(45° 90°).

2

[1)

1/3-

20 16000

18000

266

389-1,

389-2.

389-5

389-8.

2

8253-2

2.

(ISO 8253-2.

Acoustics — Audiometric test methods — Part 2: Sound field audiometry with pure tone and narrow-band test signals)

3

3.1 (threshold of hearing): 50% -

8253-1. 389. -

3.2 (ontoiogicaliy normal person): -

3.3 (reference threshold of hearing): 1/3- 18 25 -

3.4 (free sound field): -

3.5 (diffuse sound field): -

4

1. 8 1, 1/3- -

1. -


1 — 1. -

/,			L » 7, - /.
	( .20 «  , } ,	/( .20 ).	
20	78.5*	78.5	0
25	68.7	68.7	0
31.5	59.5	59.5	0
40	51.1	51.1	0
50	44.0	44.0	0
63	37.5	37.5	0
	31.S	31.5	0
	26.5	26.5	0
125	22.1	22.1	0
160	17.9	17.9	0
200	14.4	14.4	0
250	11.4	11.4	0
315	8.6	6.4	0.2

1

(. )			i* , - /.
	( ( .20 ). ) ,	Tf ( .20 ).	
400	6.2	5.8	0.4
500	4.4	3.8	0.6
630	3.0	2.1	0.9
750	2.4	1.2	1.2
800	2.2	1.0	1.2
1000	2.4	0.8	1.6
1250	3.5	1.9	1.6
1500	2.4	1.0	1.4
1600	1.7	0.5	1.2
2000	-1.3	-1.5	0.2
2500	-4.2	-3.1	-1.1
3000	-5.8	-4.0	-1.8
3150	-6.0	-4.0	-2.0
4000	-5.4	-3.8	-1.6
5000	-1.5	-1.8	0.3
6000	4.3	1.4	2.9
6300	6.0	2.5	3.5
8000	12.6	6.8	5.8
9000	13.9	8.4	5.5
10000	13.9	9.8	4.1
11200	13.0	11.5	1.5
12500	12.3	14.4	-2.1
14000	18.4	23.2	-4.8
16000	40.2	43.7	-3.5*
18000	73.2*	-	-

• 20.1600 18000

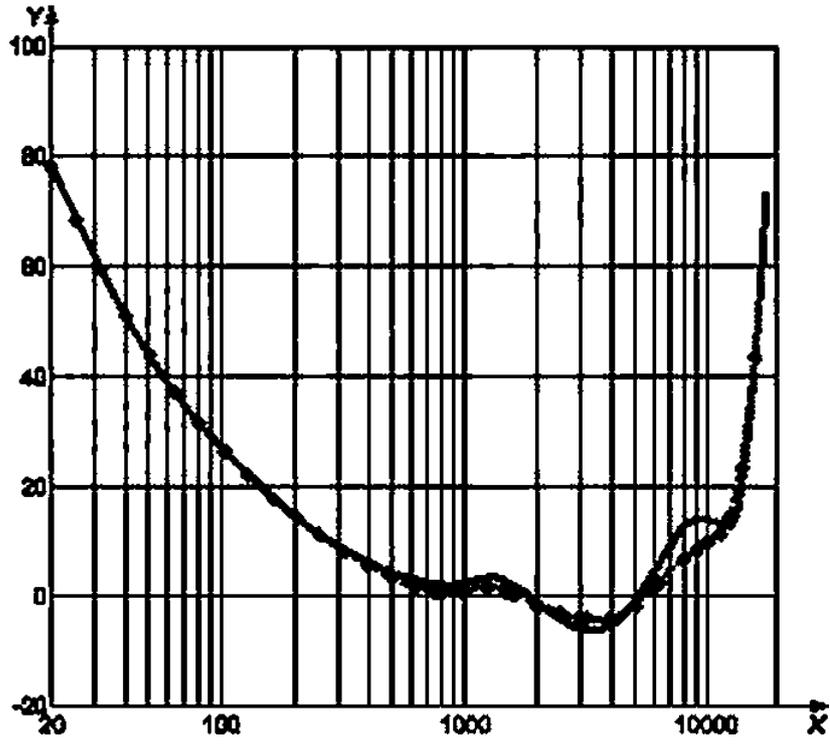

- , Tic  
Y- oejwseoro , (ft  
— - &  
- - « A\*|xtywoe \* \* \* ntv»

1 —


) 1/3-

0.1 .

( )

.1  
 20 12500  
 18000  
 226  
 15  
 226.  
 7S0  
 (.1).  
 (20) (21).  
 20 18000  
 8- .1 ; 1.  
 226.

.1.

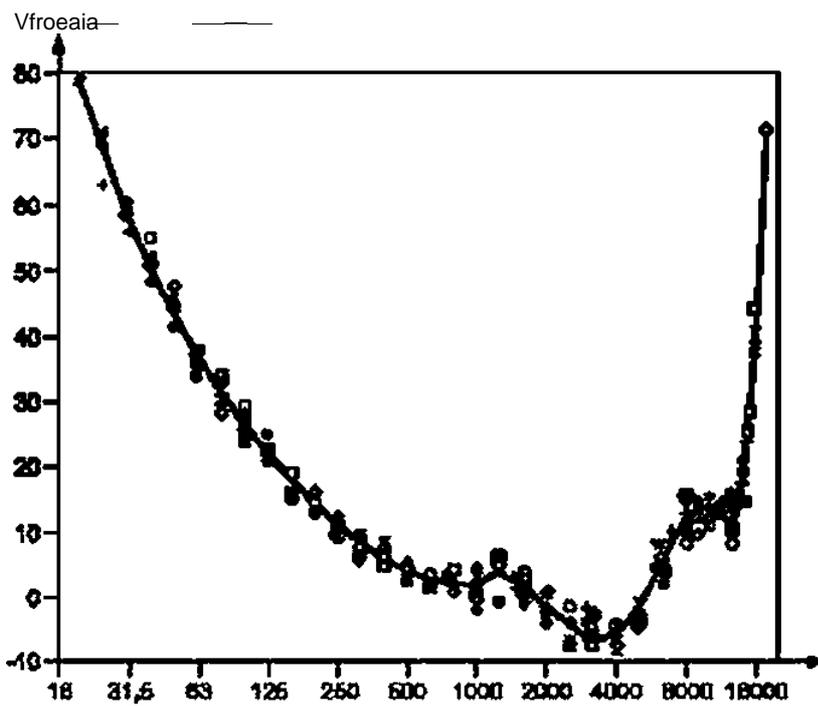

- Rounaon and Oadaon (1968); J^-Tfcenam{18B5}; X - (1978);  
 -Bate and lfMaK (1888); 0-& \*\* !(1 \*  
 + -V\*d&r\*bafI\*JMalar<19eO); ~Potewimd (1 4\*  
 ?-7tt\*A!roaat\*(.20fi2); -L\*tefwdfWlart1W7);  
 -Poteen \*w SOTO\* Q-TffcaeMmatel(190t)>^ ! \* 1.(2 1)

A.1 —

.2

43 ( . (12)—(19)).

.1 —

226 ( .1)


	(20)	(21)	(22)	(2	(24
	19S6	1965	1973	1991	2000
	2S.33. 60. 100. 200. 600. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000.7000. 6000. 10000. 12000. 15000	63.125. 250.500. 1000.2000. 3000.4000. 5000.6000. 6000. 10000	63.125.250. 500.1000. 2000. 4000. 8000	1000.4000. 8000. 9000. 10000.11 200. 12 500.14000. 16000	125.250. 500. 750.1000.1500. 2000. 3000. 4000. 6000. 8000. 9000. 10000. 11200. 12500. 14000. 16000
( )	51" (20)	11 ( 18 24)	34 42* ( 18 25)	31 ( 18 25)	31 ( 18 25)

\* 200 : 120

- a) (12);
- b) . 6
- c) [13];
- 1) : . 20
- (14);
- 2) : 26  
(14);
- d) . 12 (15); 20 40
- e) (16): 7
- f) . 16
- (16)
- L[17].
- g) . 37 (16): . 13
- ) . 97 (19);
- 40 11-
- L 1/3-
- .2 (12)—(19)

< / 1)

VfroiWi

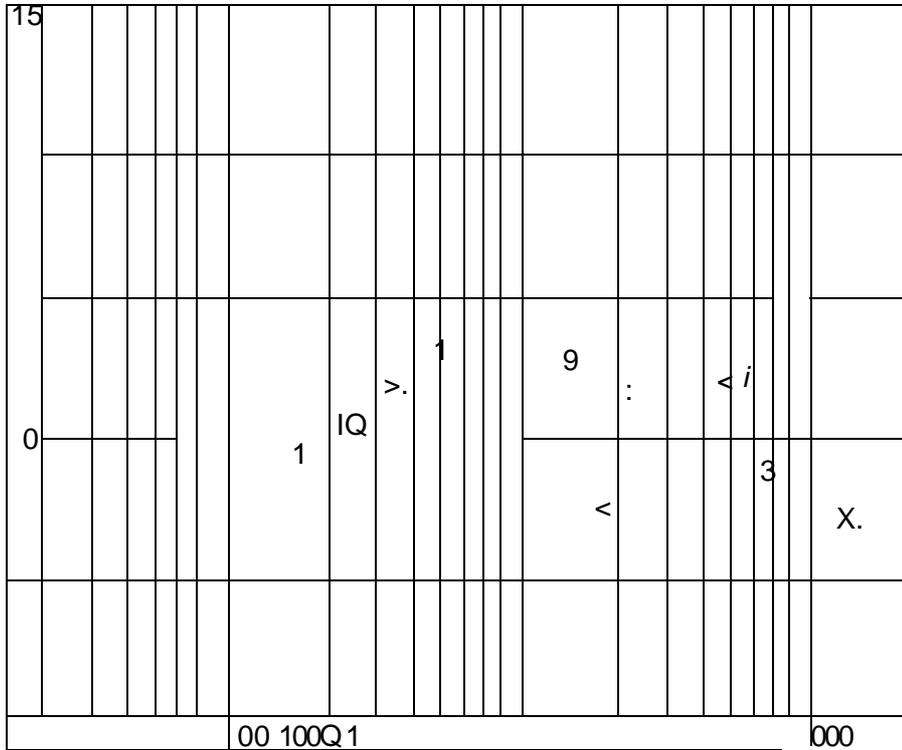

Q-no{12i - [13]; Q- [14]( );  
 •£- 11< ^ 1 31 0 » -noftSfc #-no15t  
 B-ra>ft7£ - - [10]

.2—

L.

1.

,

( )

( )

.1

8253-2	—	
226		226—2009 « . »
*		-
• — :	—	-

- (1) Threshold of Hearing: Preferred test conditions for determining hearing thresholds for standardisation. *Scand. Audiol.* 25.1996. pp. 45—52
- (2) ISO 226 Acoustics— Normal equal-loudness-level contours
- (3) ISO 266 Acoustics— Preferred frequencies
- (4) ISO 389-1 Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones
- (5) ISO 369-2 Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones
- [6] ISO 389-5 Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz
- (7) ISO 389-8 Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones
- (8) ISO 8253-1 Acoustics — Audiometric test methods — Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry
- (9) IEC 60645-1. Electroacoustics— Audiological equipment— Part 1: Pure-tone audiometers
- (10) IEC 60645-4. Audiometers — Part 4: Equipment for extended high-frequency audiometry
- (11) KUHL, W., WESTPHAL, W. Unterschiede der Lautstärken in der ebenen Welle und im diffusen Schallfeld. *Acustica*. 9.1959. pp. 407—408
- (12) JAHN, O. Über den Unterschied zwischen Kurvengleicher Lautstärke in der ebenen Welle und im diffusen Schallfeld. *Hochfrequenztechnik und Elektroakustik*. 69.1960. pp. 75—81
- (13) ROBINSON, O.W., WHITTLE, L.S., BOWSER, J.M. The loudness of diffuse sound fields. *Acustica*. 11. 1961. pp. 397—404
- (14) ZWICKER, E. Lautstärke und Leutheit. *Proceedings of 3rd international Congress on Acoustics*. 1959. Elsevier. Amsterdam. 1961. pp. 63—76
- (15) SHAW, E.A.G. The acoustics of the external ear. In: *Acoustical factors affecting hearing aid performance*. (Studebaker, G.A. and Hochberg, I. eds.). University Park Press. Baltimore. 1980. pp. 109—124
- (16) KILLION, M.G., BERGER, E.H., NUSS, R.A. Diffuse field response of the ear. *J. Acoust. Soc. Am.* 61. 1987. Suppl. 1. S 75.1
- (17) SCHMITZ, A., VORLANDER, M. Messung von Außenohr-Schallantworten mit Maximalfolgen-Hadamard-Transformation und deren Anwendung bei Inversionsversuchen. *Acustica*. 71.1990. pp. 257—266
- (18) MÖLLER, H., SØRENSEN, M.F., HAMMERSHØJ, D. and JENSEN, C.B. Head-related Transfer Functions of Human Subjects. *J. Audio Eng. Soc.* 43 (S). 1995. pp. 300—321
- (19) BRINKMANN, K., VORLANDER, M., FEOTKE, T. Re-determination of the threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions. *Acustica*. 80.1994. pp. 453—462
- (20) ROBINSON, D.W., DADSON, M.A. A re-determination of the equal-loudness relations for pure tones. *British J. Appl. Phys.* 7.1956. pp. 166—181
- (21) TERANISHI, R. Study about measurement of loudness on the problems of minimum audible sound. *Researches of the Electrotechnical Laboratory*. No. 656. Tokyo. Japan. 1965
- (22) BRINKMANN, K. Audiometer-8e2ugswelle und FretfekJ-Horschwelle. *Acustica*. 28.1973. pp. 147—154
- (23) VORLANDER, M. Freifeld-Horschwelle von 6 kHz— 16 kHz. *Fortschritte der Akustik — DAGA '91*. Bad Honnef. DPG-GmbH. 1991, pp. 533—536
- (24) POULSEN, T., HAN, L.A. The binaural free field hearing threshold for pure tones from 125 Hz to 16 kHz. *Acustica — Acta Acustica*. 86.2000. pp. 333—337

389-7—2011

534.322.3.08:006.354

13.140

34

:

,

,

,

-

& .

& .06 2012. 24,09.2012. 80 » 8 4  
. . . 1.88 .- . . 1.40. 94 . «.809  
« . 123995 , ., 4.  
www.gosbinfo.nj info@goslinfo.ru  
« « »  
« » — . « », 10S082 . .. 8.

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии